



KNO-BEHANDELSTOEL


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Medisch

DATUM: MAART 2007

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:

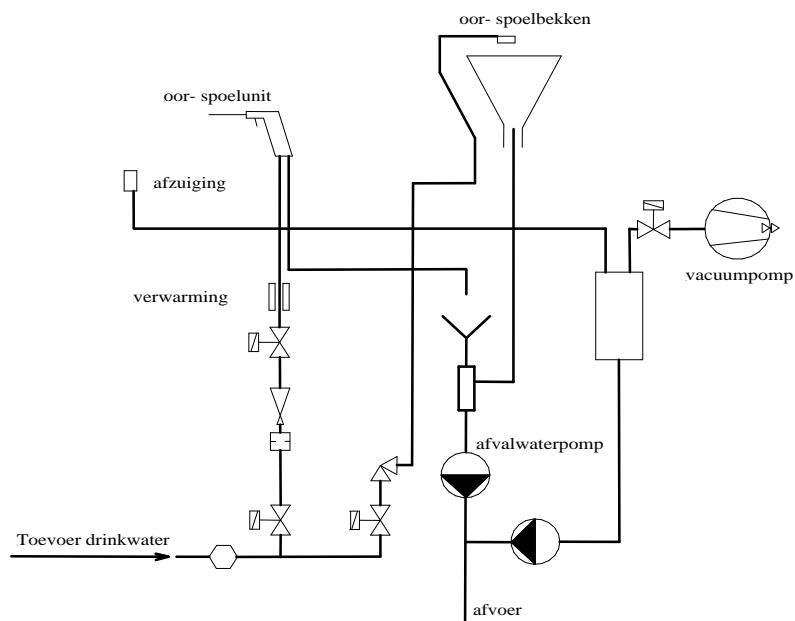

2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Microbiologische verontreiniging

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing

4. Installatiematrix

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm					☞

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB, AD.

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/ type: EA

7. Toelichting op keuze WBT:

De kans op verontreiniging door oorsmeer etc. via spoelsonde wordt als nihil beschouwd.