	TANDARTSUNIT - SPITTOON	BEOORDELINGSRAPPORT GEVAARLIJKE TOESTELLEN behorend bij WB 3.8
	Medisch	DATUM: MAART 2007
		Auterursrechten voorbehouden

1. Principeschets:

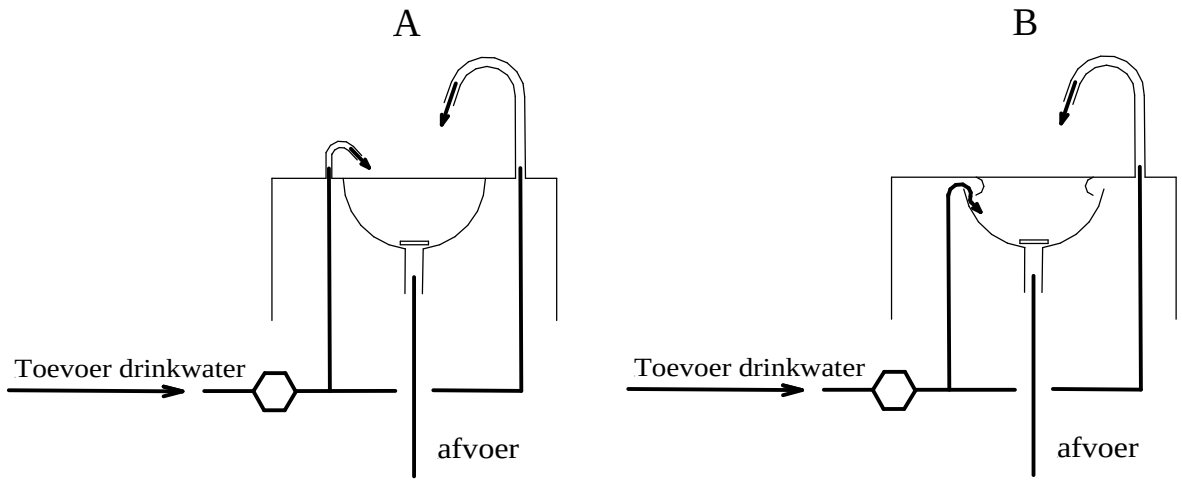

2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Speeksel en bloed uit de mond van de patiënt.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing (A en B)

4. Installatiematrix

	Vloeistofklasse				
Druk	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
P = atm					
P > atm		⊖(A)			⊖(B)

5. Beveiliging volgens NEN – EN 1717:

Familie/ type Uitvoering (A): EA,
Uitvoering (B): AA, AB, AD.

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/ type: Uitvoering (A): EA,
Uitvoering (B): AA, AB, AD.

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.

www.infodwi.nl